

Conseils pratiques et gestion des Stocks en implantologie



Jour consultation initiale...

1. Prise de rdv
2. Constitution du dossier-patient
3. Réalisation du panoramique dentaire
4. Etablissement du dossier-papier:
 1. Documents obligatoires!!!

 Antibiothérapie

 Questionnaire médical

 Consentement éclairé

 Devis

Cotations de la nomenclature

Implant: HBLD015 (NPC)

Pilier: HBLD012 (NPC)

Couronne: HBLD418: Remb S.S
(107.50)

2 implants: HBLD010 (NPC)

2 piliers: HBLD017 (NPC)

Bridge céramique: HBLD023 (NPC)

Inter sup: HBMD479 (NPC)

Bridge provisoire: HBLD034 (NPC)

Jour consultation initiale...


I. Documents annexes:

1. Schémas et explications
2. Conseils post-opératoires

II. Planification du plan de traitement:

1. Nombre de rdv & durée
2. Choix de(s) implants(s) en off...

Jour consultation initiale...

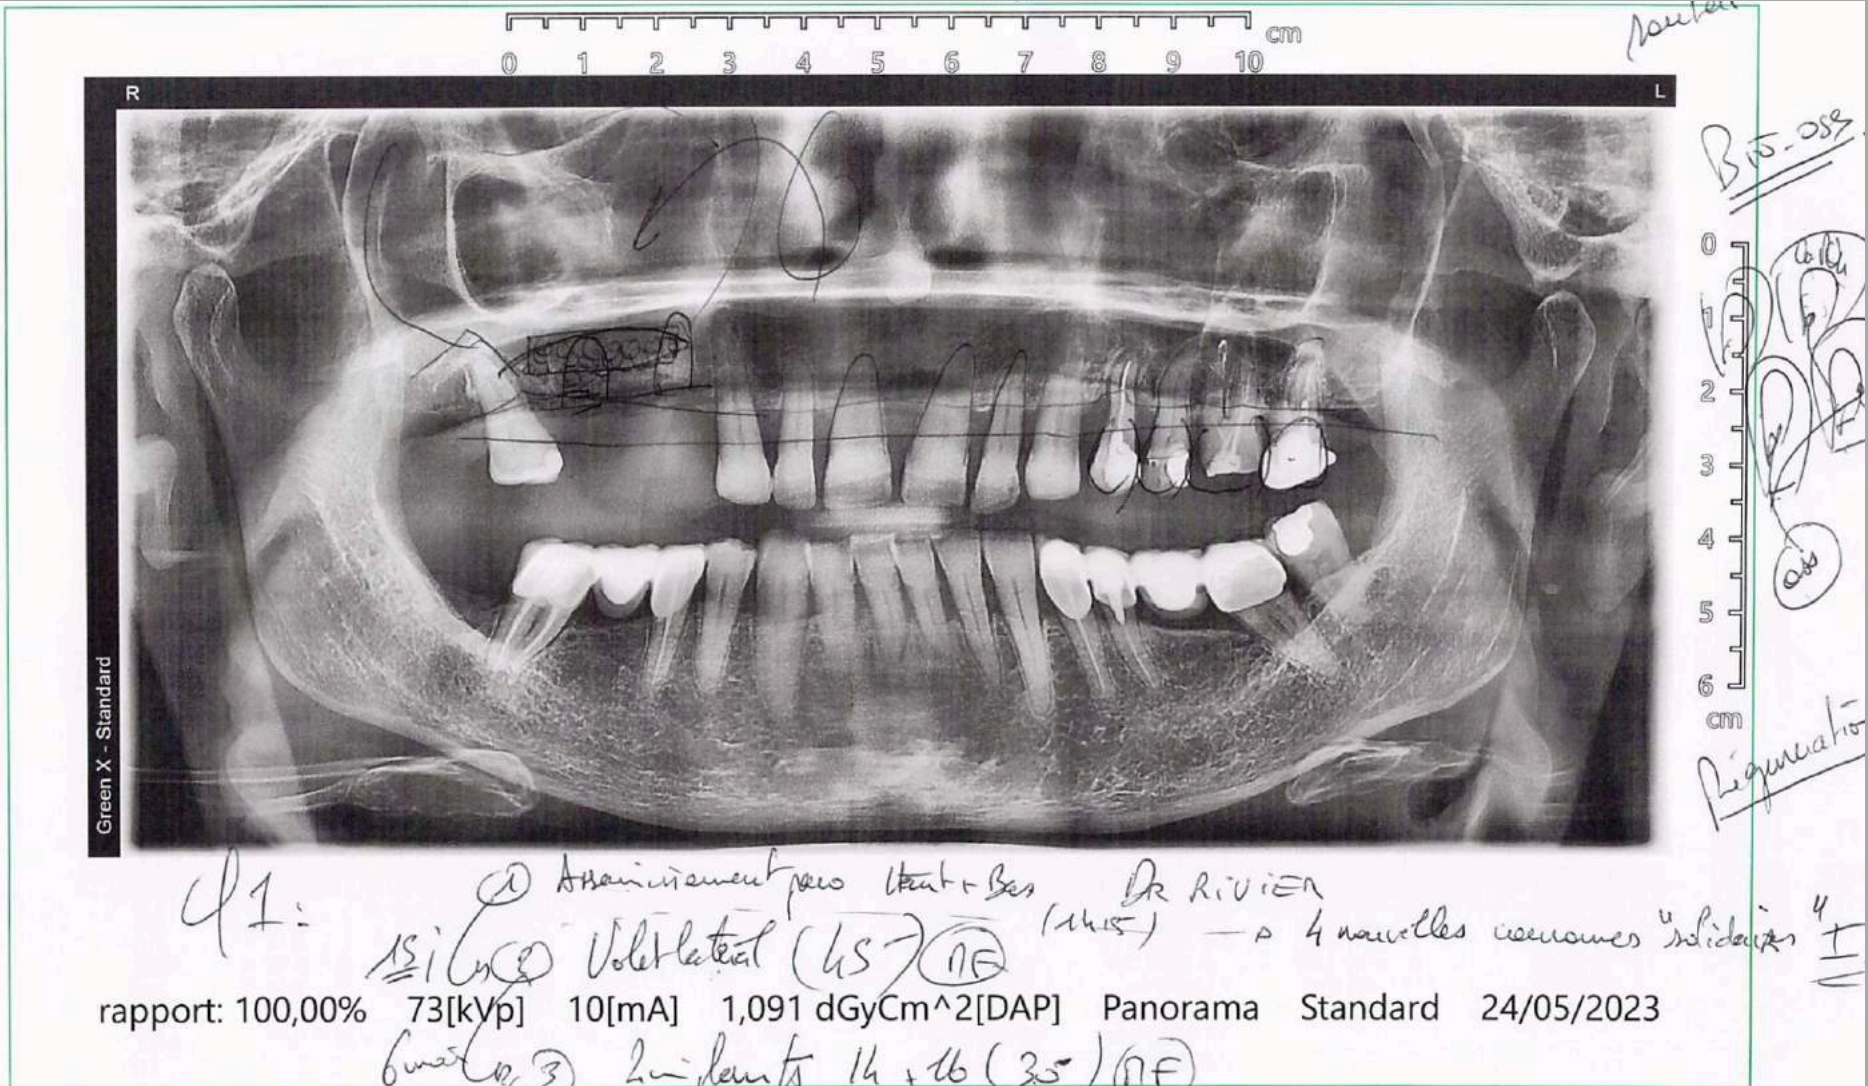

Q1:

① Aménagement pour dent + Bas Dr Rivien
 15i (15) Volatéral (45) (NF) — 4 nouvelles couronnes solides 4

rapport: 100,00% 73[kVp] 10[mA] 1,091 dGyCm²[DAP] Panorama Standard 24/05/2023

② 2 implants 14 + 16 (35) (NF)

③ Empreintes 15i → 2 piles + 1 Bridge 3 unités

Q2 = orthodontic + Blanchiment. (I) (AD) (I) (AD)

Importance de la communication
Praticien/patient
et/ou
Assistante/patient

- Expliquer SIMPLEMENT!!
- RASSURER!!
- Etre à l'écoute
- Prendre du temps



Une fois le rdv pris par patient...



Commande du matériel d'implantologie:

1. Implants
2. Vis de cicatrisation
3. Cas particuliers (mise en charge, ROG...)
4. Check-list des consommables (champs, charlottes, biseptine etc)

Pour démarrer...

Thommen		
Diamètre	Longueur	quantité
3,5	10	2
3,5	12	2
4,5	6,5	1
4,5	8	2
4,5	9,5	4
4,5	11	4
4,5	12,5	1
6	6,5	1
6	8	2
6	9,5	1
		20


PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Implant ELEMENT, capuchon de cicatrisation incl., titane


Longueur

	Endo-osseux Ø	3.5 mm	4.0 mm	4.2 mm	5.0 mm	6.0 mm
	Cœur Ø	2.8 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.3 mm	5.3 mm
6.5 mm			4.13.905	4.13.906	4.13.907	4.13.908
8.0 mm		4.13.900	4.13.904	4.13.901	4.13.902	4.13.903
9.5 mm		4.13.940	4.13.914	4.13.941	4.13.942	4.13.943
11.0 mm		4.13.910	4.13.924	4.13.911	4.13.912	4.13.913
12.5 mm		4.13.950	4.13.934	4.13.951	4.13.952	4.13.953
14.0 mm		4.13.920	4.13.944	4.13.921	4.13.922	
17.0 mm		4.13.930		4.13.931		

SPI[®]CONTACT

implant cylindro-conique

www.ifu-tm.com/THM61113

Implant CONTACT, capuchon de cicatrisation incl., titane

Longueur

	Endo-osseux Ø	2.7 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.2 mm	5.0 mm
	Cœur Ø	2.0 mm	2.8 mm	2.8 mm	3.5 mm	4.3 mm
9.5 mm			4.13.214	4.13.211	4.13.212	4.13.213
11.0 mm		4.13.220	4.13.224	4.13.221	4.13.222	4.13.223
12.5 mm		4.13.230	4.13.234	4.13.231	4.13.232	4.13.233
14.0 mm		4.13.240	4.13.244	4.13.241	4.13.242	4.13.243
17.0 mm				4.13.261	4.13.262	

Hauteur					
2.0 mm	4.03.520	4.03.524	4.03.521	4.03.522	4.03.523
3.2 mm	4.03.530	4.03.534	4.03.531	4.03.532	4.03.533
4.5 mm	4.03.540	4.03.544	4.03.541	4.03.542	4.03.543
7.0 mm	4.03.550	4.03.554	4.03.551	4.03.552	4.03.553




🔓 Façonneur gingival+, 4 lobes, titane

Hauteur				
2.0 mm	4.03.525			
3.2 mm	4.03.535			



🔓 Façonneur gingival, adaptable, titane/résine en base de PMMA

Hauteur					
7.5 mm	4.03.570	4.03.571	4.03.572	4.03.573	4.03.574



La vis d'abutment n'est pas incluse.

Vis pour modelage, 4 lobes, pour façonneur gingival adaptable, aluminium anodisé (dans la limite des stocks disponibles)

Longueur				
22.5 mm	3.03.570			
23.4 mm		3.03.571		



Vis pour modelage, 4 lobes, pour façonneur gingival adaptable et VARIOtemp, acier inoxydable, 4 pièces par unité (Q4)


Longueur				
22.5 mm	3.03.590 Q4			
23.4 mm		3.03.591 Q4		





Vis d'abutment, 4 lobes, alliage de titane

Longueur				
5.8 mm	4.03.500			
7.2 mm		4.03.501		
10.2 mm		4.03.502		



 **Coiffe d'empreinte** pour porte-empreinte ouvert, usage unique, rétentive, vissée, aluminium anodisé


Hauteur		PF 3.5	PF 4.0	PF 4.5	PF 5.0	PF 6.0	
∅ extérieur		3.8 mm	4.3 mm	4.8 mm	5.3 mm	6.3 mm	
cylindrique 10.0 mm		3.03.010	3.03.018	3.03.011	3.03.012	3.03.013	
∅ extérieur		3.8 mm	5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm	7.0 mm	
cylindrique 10.0 mm			3.03.078	3.03.071	3.03.072	3.03.073	



Acier revêtu, inoxydable

Longueur ∅

17.0 mm	6.0 mm	3.03.522 *					
---------	--------	-------------------	--	--	--	--	---








* La poignée pour positionnement (réf. art. 3.03.522) peut être utilisée pour toutes les coiffes d'empreinte au niveau implant (sauf les coiffes d'empreinte de la hauteur 16.0 mm).

 **Coiffe d'empreinte** pour porte-empreinte ouvert, réutilisable, rétentive, vissée, titane

Hauteur		PF 3.5	PF 4.0	PF 4.5	PF 5.0	PF 6.0	
∅ extérieur		3.8 mm	4.3 mm	4.8 mm	5.3 mm	6.3 mm	
cylindrique 16.0 mm		3.04.020	3.04.021	3.04.022	3.04.023	3.04.024	
∅ extérieur		3.8 mm	5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm	7.0 mm	
conique 16 mm			3.04.037	3.04.038	3.04.039	3.03.040	

Vis pour coiffes d'empreinte, réutilisable, 4 lobes, acier inoxydable

Longueur

12.5 mm	extracourt	3.03.572					
16.5 mm	court	3.03.573					
21.5 mm	Longueur	3.03.574					
27.5 mm	extralong	3.03.580					
13.2 mm	extracourt			3.03.575			
17.2 mm	court			3.03.576			
22.2 mm	Longueur			3.03.577			
28.2 mm	extralong			3.03.581			

Sélection de la longueur de vis appropriée:

Analogues au niveau implant

🔒 Anti-rotationnel
🔓 Rotationnel

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

🔒 **Analogue au niveau implant, titane**



Longueur

14.0 mm	3.03.090	3.03.095	3.03.091	3.03.092	3.03.093*
22.0 mm	3.03.060	3.03.061	3.03.065	3.03.062	3.03.063

Les analogues d'implant sont utilisés pour la prise d'empreinte avec coiffes d'empreinte au niveau implant.

* Pour des raisons de construction, la longueur est de 15.0 mm

🔒 **Analogue au niveau implant pour CAD/CAM, alliage de titane**



numérique

Longueur

11.4 mm	3.03.085	3.03.086	3.03.087	3.03.088	3.03.089
---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Les analogues d'implant pour CAD/CAM sont utilisés en cas de prise d'empreinte numérique par scanner intraoral.



Check-list Matériel Chirurgie Implantaire

1-Préparation Equipe :

BROSSE CHIRURGICALE	<input type="checkbox"/>
BLOUSE PRATICIEN/ASSISTANTE	<input type="checkbox"/>
CALOT/CHARLOTTE	<input type="checkbox"/>
MASQUE FFP2/CHIRURGICAL	<input type="checkbox"/>
LUNETTES DE PROTECTION/LOUPES	<input type="checkbox"/>
ESSUI-MAINS STERILES	<input type="checkbox"/>
GANTS STERILES LATEX	<input type="checkbox"/>
GANTS STERILES SANS LATEX	<input type="checkbox"/>

2-Préparation patient :

BLOUSE PATIENT	<input type="checkbox"/>
CHAMP PATIENT	<input type="checkbox"/>
CHARLOTTE	<input type="checkbox"/>
SURCHAUSSURES	<input type="checkbox"/>
RADIO IMPRIMEE	<input type="checkbox"/>

3-Préparation salle d'intervention

RADIO IMPRIMEE	<input type="checkbox"/>
GUIDE CHIRURGICAL	<input type="checkbox"/>
COMPRESSES	<input type="checkbox"/>
SERINGUES	<input type="checkbox"/>
CARPULES	<input type="checkbox"/>
AIGUILLE	<input type="checkbox"/>
BISEPTINE	<input type="checkbox"/>
IMPLANTS	<input type="checkbox"/>
VIS DE CICATRISATION DE DIFFERENTES HAUTEURS	<input type="checkbox"/>
CHAMPS DE TABLE	<input type="checkbox"/>
CHAMP PATIENT	<input type="checkbox"/>
GAINES DE PROTECTION	<input type="checkbox"/>

4-PLATEAU DE CHIRURGIE

MIROIR	<input type="checkbox"/>
SONDE	<input type="checkbox"/>
PRECELLES	<input type="checkbox"/>
ECARTEUR	<input type="checkbox"/>

DECOLLEUR	<input type="checkbox"/>
CURETTE	<input type="checkbox"/>
CK6	<input type="checkbox"/>
CISEAUX	<input type="checkbox"/>
PINCES A SUTURE	<input type="checkbox"/>
PRECELLE DE CHIRURGIE	<input type="checkbox"/>
BISTOURI	<input type="checkbox"/>
CUPULE	<input type="checkbox"/>
PINCE-GOUGE	<input type="checkbox"/>
BOITE DE CHIRURGIE IMPLANTAIRE	<input type="checkbox"/>
LAME DE BISTOURI N°15	<input type="checkbox"/>
SUTURE	<input type="checkbox"/>
CANULES D'ASPIRATION CHIRURGICALE	<input type="checkbox"/>
PROTECTION STERILES STERILES POUR POIGNEES DE SCIALTYIQUE	<input type="checkbox"/>
CONTRE-ANGLE DE CHIRURGIE	<input type="checkbox"/>
SYSTEME D'IRRIGATION	<input type="checkbox"/>
POCHE DE SERUM PHYSIOLOGIQUE	<input type="checkbox"/>

+ SI ROG :

GODET A BIOMATERIAU	<input type="checkbox"/>
CUILLERE A OS	<input type="checkbox"/>
BIOMATERIAU	<input type="checkbox"/>
MEMBRANE	<input type="checkbox"/>

+ SI EXTRACTION :

DAVIER	<input type="checkbox"/>
ELEVATEUR	<input type="checkbox"/>
SYNDESMOTOME	<input type="checkbox"/>
PIECE A MAIN DE CHIRURGIE	<input type="checkbox"/>
FRAISE DE CHIRURGIE (STERILE !)	<input type="checkbox"/>

+ SI MECL :

PROTHESE PROVISOIRE	<input type="checkbox"/>
RESINE	<input type="checkbox"/>
SPATULE/GODET	<input type="checkbox"/>
ANALOGUE	<input type="checkbox"/>
TEFLON	<input type="checkbox"/>
CAVIT	<input type="checkbox"/>
CIMENT PROVISOIRE	<input type="checkbox"/>

Côté pharmacie, PREVOIR :


AMOXICILLINE	<input type="checkbox"/>
DOLIPRANE/IBUPOFENE	<input type="checkbox"/>
COUSSIN THERMIQUE	<input type="checkbox"/>



Sélection de la catégorie de produits

Catégorie de produits
Vue simple par catégories de produits

Spécificité
Présentation pratique par plateforme souhaitée

Accès direct aux catégories de produits
Sélection directe des catégories de produits

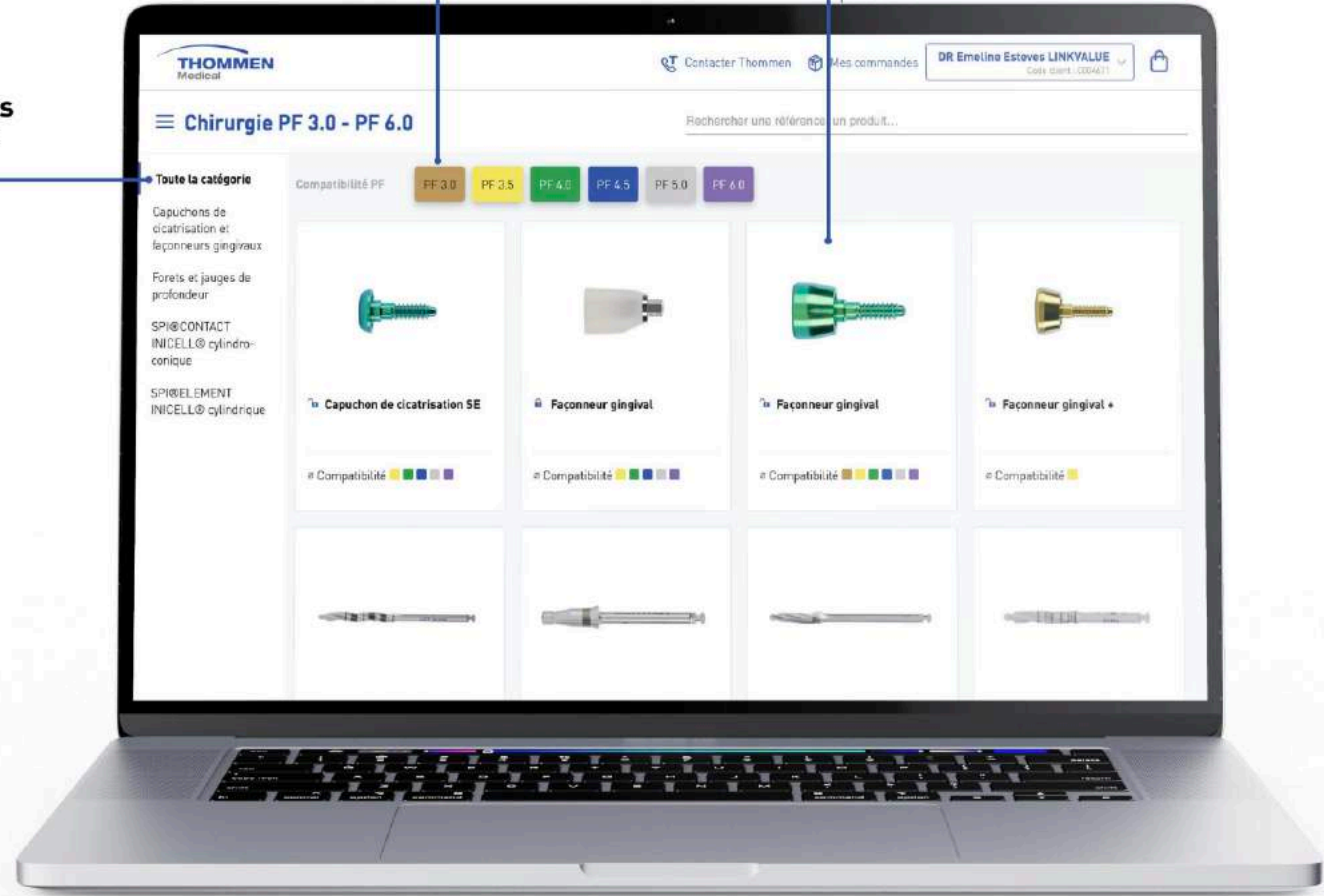

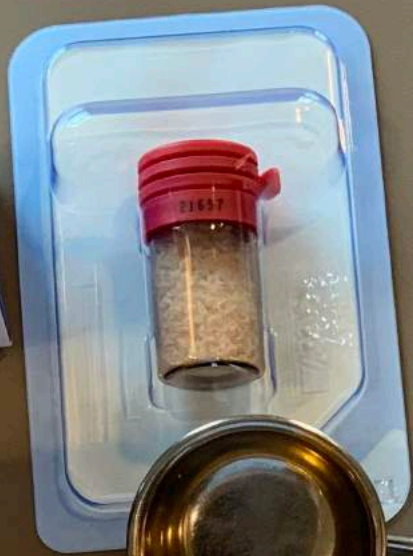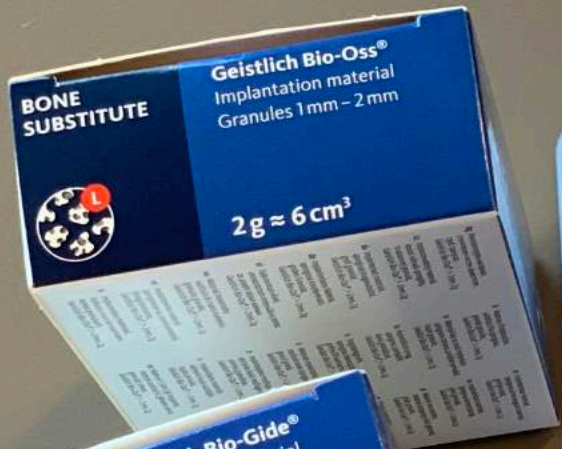

- Respect de la règle FIFO
- Etablir un protocole de commande avec la quantité minimale à avoir au cabinet (attention aux stocks trop importants)
- Mouchard sur l'avant dernier produit

JOUR J-1...

- Allô patient:



- 📌 rappel du Rdv
- 📌 prise d'antibio
- 📌 docs à remplir
- 📌 on rassure...

JOUR J.....



Avant de commencer la chirurgie:

- Les consentements éclairés
- Le devis signé (+échéancier financier)
- Le bilan de santé
- Eventuellement photos avant/après...

JOUR J....

- Anesthésie locale
- Assainissement du site opératoire
- Préparation de la salle d'op
- Habillage patient
- Préparation équipe médicale
- Enfin...la chirurgie!!!
- Nettoyage, reconditionnement des DM etc...
- Traçabilité: passeport implantaire!

PASSEPORT IMPLANTAIRE



SCP DÔM IMPLANT
Docteur Dominique AUBAZAC
Docteur Mathieu FILLION
12-14 avenue Julien
63000 CLERMONT FERRAND
Tel 04.73.93.28.14

Nom : MELINE
Prénom : Arlette
Date de naissance : 25/06/1955

Date d'intervention : 02/05/2012
Chirurgien Dentiste : Docteur Dominique Aubazac
Reference Implant : STRAUMANN-033.454S
Lot : T2753
Position : 12

Date d'intervention : 02/05/2012
Chirurgien Dentiste : Docteur Dominique Aubazac
Reference Implant : STRAUMANN-033.454S
Lot : CP084
Position : 22

Date d'intervention : 02/05/2012
Chirurgien Dentiste : Docteur Dominique Aubazac
Reference Implant : STRAUMANN-033.054S
Lot : CV807
Position : 13

Date d'intervention : 02/05/2012
Chirurgien Dentiste : Docteur Dominique Aubazac
Reference Implant : STRAUMANN-033.054S
Lot : CV807
Position : 23

JOUR J+1



- Prise de nouvelle patient



JOUR J+50...

- Commandes des pièces prothétiques:



Transfert




Analogue





Vis de cicat + haute



Locators

 **Coiffe d'empreinte** pour porte-empreinte ouvert, usage unique, rétentive, vissée, aluminium anodisé


Hauteur		PF 3.5	PF 4.0	PF 4.5	PF 5.0	PF 6.0	
∅ extérieur	3.8 mm						
∅ extérieur	4.3 mm						
∅ extérieur	4.8 mm						
∅ extérieur	5.3 mm						
∅ extérieur	6.3 mm						
cylindrique 10.0 mm		3.03.010	3.03.018	3.03.011	3.03.012	3.03.013	
∅ extérieur	3.8 mm						
∅ extérieur	5.0 mm						
∅ extérieur	5.5 mm						
∅ extérieur	6.0 mm						
∅ extérieur	7.0 mm						
cylindrique 10.0 mm			3.03.078	3.03.071	3.03.072	3.03.073	



Acier revêtu, inoxydable

Longueur	∅	
17.0 mm	6.0 mm	3.03.522 *



* La poignée pour positionnement (réf. art. 3.03.522) peut être utilisée pour toutes les coiffes d'empreinte au niveau implant (sauf les coiffes d'empreinte de la hauteur 16.0 mm).

 **Coiffe d'empreinte** pour porte-empreinte ouvert, réutilisable, rétentive, vissée, titane



Hauteur		PF 3.5	PF 4.0	PF 4.5	PF 5.0	PF 6.0	
∅ extérieur	3.8 mm						
∅ extérieur	4.3 mm						
∅ extérieur	4.8 mm						
∅ extérieur	5.3 mm						
∅ extérieur	6.3 mm						
cylindrique 16.0 mm		3.04.020	3.04.021	3.04.022	3.04.023	3.04.024	
∅ extérieur	3.8 mm						
∅ extérieur	5.0 mm						
∅ extérieur	5.5 mm						
∅ extérieur	6.0 mm						
∅ extérieur	7.0 mm						
conique 16 mm			3.04.037	3.04.038	3.04.039	3.03.040	

Vis pour coiffes d'empreinte, réutilisable, 4 lobes, acier inoxydable

Longueur		PF 3.5	PF 4.0	PF 4.5	PF 5.0	PF 6.0
12.5 mm	extracourt	3.03.572				
16.5 mm	court	3.03.573				
21.5 mm	Longueur	3.03.574				
27.5 mm	extralong	3.03.580				
13.2 mm	extracourt			3.03.575		
17.2 mm	court			3.03.576		
22.2 mm	Longueur			3.03.577		
28.2 mm	extralong			3.03.581		



Analogues au niveau implant

 Anti-rotationnel
 Rotationnel

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Analogue au niveau implant, titane



Longueur

14.0 mm

3.03.090

3.03.095

3.03.091

3.03.092

3.03.093*

22.0 mm

3.03.060

3.03.061

3.03.065

3.03.062

3.03.063

Les analogues d'implant sont utilisés pour la prise d'empreinte avec coiffes d'empreinte au niveau implant.

* Pour des raisons de construction, la longueur est de 15.0 mm

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM, alliage de titane



 numérique

Longueur

11.4 mm

3.03.085

3.03.086

3.03.087

3.03.088

3.03.089



Les analogues d'implant pour CAD/CAM sont utilisés en cas de prise d'empreinte numérique par scanner intraoral.

Et en optique...



Abutment de scannage

www.ifu-tm.com/THM61143

 Anti-rotationnel
 Rotationnel

PF 3.5	PF 4.0	PF 4.5	PF 5.0	PF 6.0
--------	--------	--------	--------	--------

 **Abutment de scannage**, avec revêtement



3.03.775	3.03.776	3.03.777	3.03.778	3.03.779
----------	----------	----------	----------	----------



Vis pour coiffes d'empreinte, réutilisable, 4 lobes, acier inoxydable

Longueur



12.5 mm	extracourt	3.03.572				
13.2 mm	extracourt				3.03.575	



Attention: Thommen Medical met à disposition les bibliothèques correspondantes de CAO. Un aperçu se trouve sur www.thommenmedical.com.

Les indispensables...

 Clé à cliquer

 Tournevis

 Clé à piliers

 Clé “Locator”



Clé à cliquer dynamométrique MONO, alliage de titane

Longueur
110.0 mm

3.03.160

Tournevis MONO, 4 lobes, acier inoxydable/PEEK

	extracourt *	court	Longueur
Longueur	14.5 mm	22.2 mm	28.2 mm
Longueur d'axe	5.1 mm	10.3 mm	16.3 mm
	3.03.165	3.03.166	3.03.167



Les indispensables...



Un peu de révision...

Pour un bridge transvissé 3 éléments

- [Chez THOMMEN \(empreinte vissée\):](#)
 - 2 implants (4.23.134 : diamètre 4,5 de longueur 9.5)
 - 2 vis (4.03.53 I : vis de 3,2 mm)
 - 2 analogues (3.0370 I)
 - 2 transferts(3.03.01 I)
 - 2 calcinables (2.0373 I)
 - 2 piliers Variomulti (4.03602)
 - Vis oclusales (4.03.507)

Usinage

- Adaptation parfaite
- Reproductibilité
- Structure homogène
- Passivité



u axes!



Createch Medical Vendredi 7 Avril 2017







Fournisseurs habituels: entre 34 et 39 € les 6
(3 tailles haut et bas)

Mon Prothésiste...

Se mettre d'accord avec son prothésiste:

- JE commande
- IL commande
- Récupérer** les pièces pour ce créer un stock



φ 4,5

Transferts

Transferts vissés φ 3,5	Transferts vissés φ 4,5	Transferts vissés φ 5
Analogues φ 3,5	Analogues φ 4,5	Analogues φ 5
Piliers prov φ 3,5 bridge	Piliers prov φ 4,5 bridge	Piliers prov φ 5 couronne et bridge

Anc sphér. Thomsen Court
Anc. Sphér. Long
Analogues

Vis bleues ↓	Vis jaunes ↓	Capuchons Variomulti	Vis réline Transmissées
Vis bleues	Vis jaunes	Capuchons Variomulti	Piliers ang φ 3,5
Vis bleues	Vis jaunes	Vis occlusales	Piliers ang φ 4,5
		Vis occlusales	

Piliers prov φ 3,5 couronne	Piliers prov φ 4,5 couronne	Transferts vissés φ 6
Variomulti φ 3,5 φ 6	Variomulti φ 4,5	Analogues φ 6
Variomulti angulé Piliers prov.	Variomulti Transferts vissés et Analogues	Piliers prov φ 6 couronne et bridge

Prothèse φ 3,5	Variomulti φ 3,5			forte-imp ↓
Prothèse φ 4,5	Variomulti φ 4,5	Transf. réposition. φ 4,5		
Prothèse φ 5	Variomulti φ 5			
Prothèse φ 6		Transferts Rapet. φ 6		

REC Variomulti

ENP IAPL

Numéros utiles

THOMMEN: Yoann SONTTHONNAX	06 34 11 71 39
KOMET: François BOTTA	06 70 74 64 31
WH France: Yves SOULIER	06 18 42 25 15
DEXTER: Sabine FUSTIER	06 25 23 36 52
GEISTLICH : Valérie LESNE:	06 08 92 11 42

Merci pour votre attention..

